

## 「サラヤ消毒用エタノール 500mL」

## 製造移管に伴う仕様変更案内

拝啓 時下益々ご盛栄のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、関東医薬品工場への製造移管に伴い、下記のとおり変更させていただくことになりましたので、ご案内申し上げます。

今後とも弊社製品をご愛顧賜りますよう、何卒お願い申し上げます。

敬具

記

## 【対象品目】

44105:サラヤ消毒用エタノール 500mL

※仕様変更品の切替予定時期につきましては、別途、スケジュール一覧をご参照ください。

## 【変更内容】

① 個箱包装を廃止いたします。それに伴い、外装サイズを変更いたします。

旧（現行品）	新（仕様変更品）
W365×D294×H200mm	W345×D274×H204mm

② 外装デザインを変更いたします。


旧（現行品）	新（仕様変更品）

③ GS1 印字位置を個箱からラベルに変更するのに伴い、ラベルデザインを変更いたします。

現行品は個箱に GS1 印字をしておりましたが、ラベルの青点線枠を目安に GS1 ラベルを貼ります（GS1 印字内容は変更ございません）。実際のラベルデザインには青点線枠は印刷されません。

また、製造番号および使用期限につきましてはボトル底面への印字が無くなるため、GS1 コードからの読み取りをお願いいたします。

## 旧（現行品）

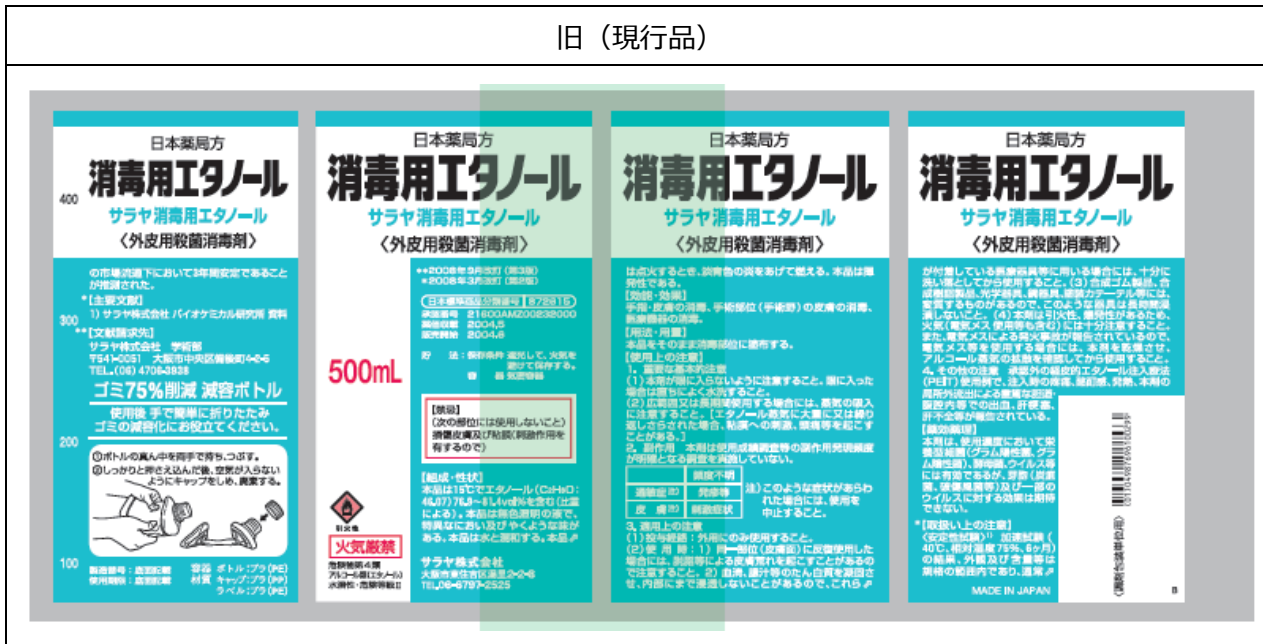

## 新（仕様変更品）



以上