

「サラサイド除菌クロス」仕様変更のご案内（第1報）

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度「サラサイド除菌クロス」につきまして、下記のとおり変更させていただくことになりましたので、ご案内申し上げます。なお、仕様及び価格、各種コード、入数等の変更はございません。

引き続き本品をご愛顧賜りますよう、宜しく願い申し上げます。

敬具

記

【対象商品および切替予定時期】

商品コード	商品名	切替予定時期
44186	サラサイド除菌クロス30枚ピロー型	未定（順次ご案内）
51673	サラサイド除菌クロス480枚容器	
51676	サラサイド除菌クロス480枚詰替	
51681	サラサイド除菌クロス80枚容器	2026年8月上旬
51682	サラサイド除菌クロス80枚詰替	2026年6月下旬
51684	サラサイド除菌クロス250枚容器	2026年9月上旬
51685	サラサイド除菌クロス250枚詰替	2026年6月中旬
51686	サラサイド除菌クロス80枚ピロー型	2026年4月下旬

※切替予定時期は目安であり、出荷倉庫によって時期が変動する可能性があります。


詳細は裏面をご参照ください。

【変更内容】プラスチック製フタ部分のデザインに「使用終了の目安」欄を追加

例) サラサイド除菌クロス80枚ピロー型



例) サラサイド除菌クロス250枚容器

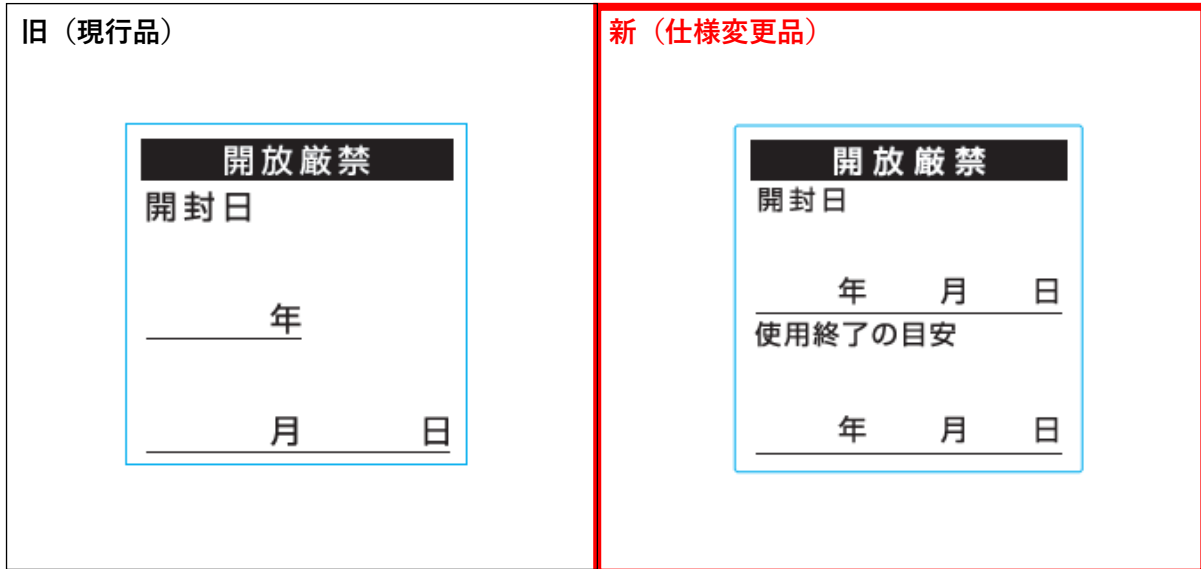

以上