

## 「サラサイド除菌クロス」仕様変更のご案内（第2報）

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度「サラサイド除菌クロス」につきまして、下記のとおり変更させていただくことになりましたので、ご案内申し上げます。なお、仕様及び各種コード、入数等の変更はございません。

引き続き本品をご愛顧賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

### 【対象商品および切替予定時期】

商品コード	商品名	切替予定時期
51673	サラサイド除菌クロス480枚容器	未定（順次ご案内）
51676	サラサイド除菌クロス480枚詰替	
51681	サラサイド除菌クロス80枚容器	2026年8月上旬頃
51682	サラサイド除菌クロス80枚詰替	2026年6月下旬頃
51684	サラサイド除菌クロス250枚容器	2026年10月中旬頃
51685	サラサイド除菌クロス250枚詰替	2026年7月上旬頃
51686	サラサイド除菌クロス80枚ピロー型	切替済み

※切替予定時期は目安であり、出荷倉庫によって時期が変動する可能性がございます。


※詳細は次頁をご参照ください。

【変更内容】プラスチック製フタ部分のデザインに「使用終了の目安」欄を追加

例) サラサイド除菌クロス80枚ピロー型



例) サラサイド除菌クロス250枚容器

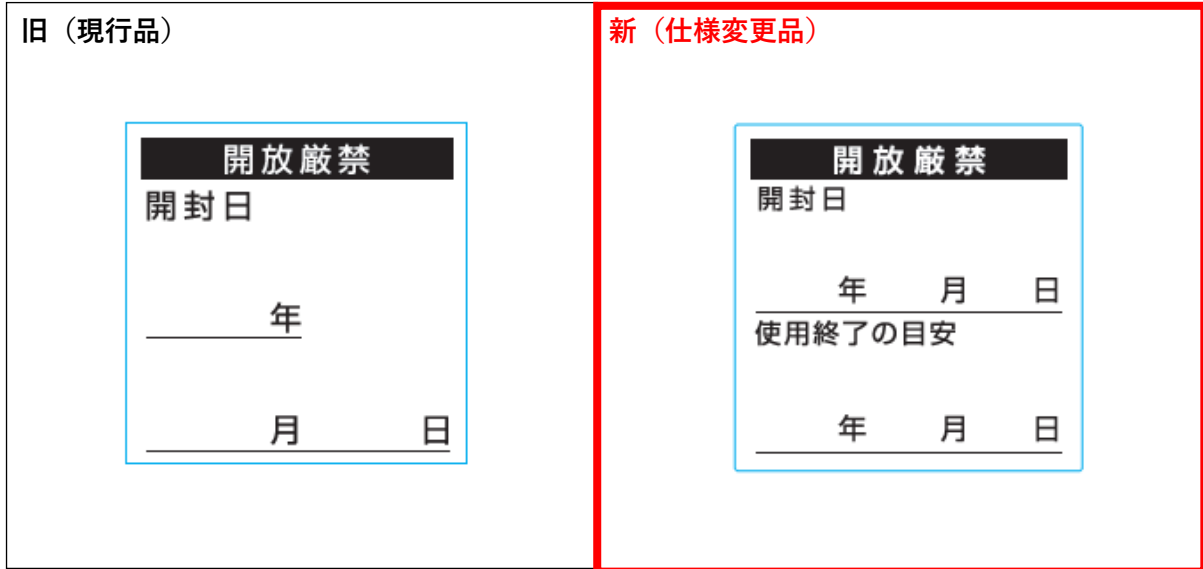

以上